

## Inleiding

Deze verpakking bevat een FlexPro® PenMate® hulpmiddel bij het automatisch injecteren, een bewaartui, en deze handleiding.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u FlexPro® PenMate® gaat gebruiken (in het vervolg van deze handleiding zal de naam PenMate® worden gebruikt). De instructies bevatten informatie over het gebruik, het bewaren en het reinigen van uw PenMate®. U moet de instructies lezen, zelfs als u eerder andere toedieningssystemen van Novo Nordisk heeft gebruikt.

PenMate® is ontworpen om u te helpen met het injecteren van groeihormoon door de naald uit het zicht te houden tijdens de injectie met Norditropin® FlexPro® 5, 10 of 15 mg/1,5 ml.

Norditropin® FlexPro® is een pen, voorgevuld met groeihormoon, voor gebruik door slechts één persoon. Norditropin® FlexPro® is ontworpen voor gebruik met NovoFine® of NovoTwist® naalden voor eenmalig gebruik met een lengte van maximaal 8 mm. Gebruik uw pen of PenMate® niet zonder uitleg van uw arts of verpleegkundige. Lees de Norditropin® FlexPro® 5, 10 of 15 mg/1,5 ml bijsluiting voordat u PenMate® gaat gebruiken.

De illustraties in deze handleiding laten zien hoe PenMate® in combinatie met Norditropin® FlexPro® 5 mg/1,5 ml wordt gebruikt.

Belangrijke en extra informatie wordt duidelijk aangegeven door de tekens die je hieronder ziet:


### ⚠️ Belangrijke informatie

Let vooral op deze informatie, omdat deze belangrijk is voor een veilig gebruik van uw pen of PenMate®.


### 📖 Extra informatie

Nuttige informatie voor het gebruik van uw pen en PenMate®.


## FlexPro® PenMate®

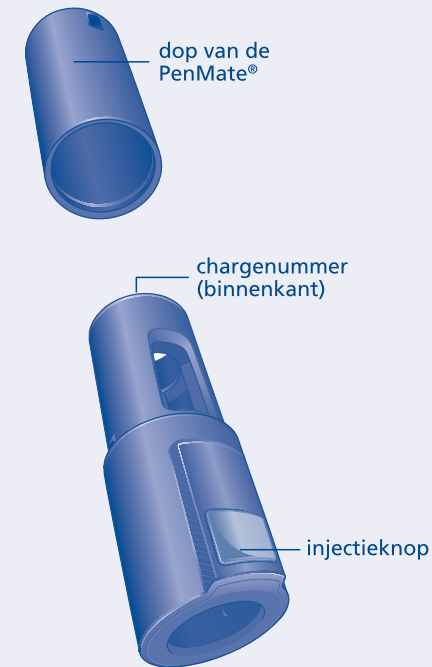

## Norditropin® FlexPro® 5 mg/1,5 ml (voorbeeld)

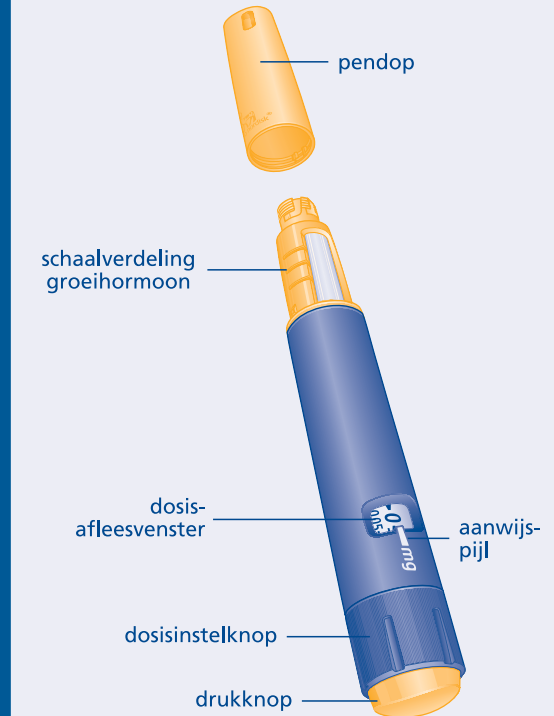

### Naald (voorbeeld)

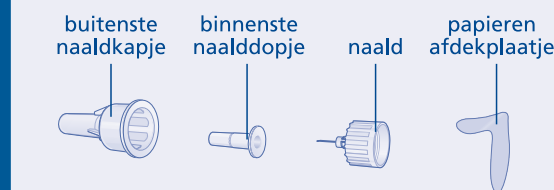

## ⚠️ Belangrijke informatie

Lees deze belangrijke informatie door voordat u uw PenMate® gaat gebruiken.

- PenMate® mag alleen worden gebruikt in combinatie met Norditropin® FlexPro® 5, 10 of 15 mg/1,5 ml.
- Als u uw PenMate® kwijtraakt of beschadigt, kunt u de Norditropin® FlexPro® pen zonder PenMate® gebruiken.
- PenMate® is alleen voor gebruik door één persoon. Deel uw pen, PenMate® of uw naalden nooit met anderen. Dit kan leiden tot kruisbesmetting.
- Bewaar uw pen, PenMate® en naalden altijd buiten bereik van anderen, met name kinderen.
- Zorgverleners dienen gebruikte naalden zorgvuldig te hanteren om het risico op letsel door de naald en kruisbesmetting te verkleinen.

### Pentabel


Raadpleeg onderstaande tabel voor een kort overzicht van alle Norditropin® FlexPro® pennen en hun verschillen in groeihormoonsterkte, kleur, minimale en maximale doses.

Norditropin® FlexPro®	5 mg/ 1,5 ml	10 mg/ 1,5 ml	15 mg/ 1,5 ml
Kleurcode			
Min. dosis			
	0,025 mg	0,05 mg	0,1 mg
Max. dosis			
	2,0 mg	4,0 mg	8,0 mg


## Uw PenMate® gereedmaken voor gebruik

Voordat u uw PenMate® gereedmaakt, dient u altijd de naam, sterkte en het gekleurde label van uw Norditropin® FlexPro® pen te controleren om er zeker van te zijn dat deze de juiste sterkte groeihormoon bevat.

**A** Haal de dop van uw PenMate®.




**B** Haal de dop van de pen. Deze heeft u niet nodig met uw PenMate®.



Controleer of de groeihormoonoplossing in de pen helder en kleurloos is door de pen een of twee keer om te zwenken. Als de oplossing er troebel of vlokkelig uitziet, moet u de pen niet gebruiken.

**C** Druk Norditropin® FlexPro® in PenMate® en draai de pen totdat u een klik hoort of voelt.



Het dosisafleesvenster op de pen zal in één lijn staan met de injectieknop op uw PenMate®.


**D** Neem een nieuwe naald voor eenmalig gebruik en verwijder het papieren afdekplaatje.




**E** Houd de pen vast en draai de naald er recht op. Zorg ervoor dat de naald stevig vastzit.




**F** Haal het buitenste naaldkapje eraf en bewaar het.




Na de injectie heeft u het weer nodig om de naald op de juiste manier van de pen af te halen.



**G** Verwijder het binnenste naaldkapje en gooi het weg.



Als u het dopje probeert terug te plaatsen, zou u zich per ongeluk aan de naald kunnen prikken.



Er kan een druppel groeihormoon aan de naaldpunt verschijnen. Dit is normaal.



**H** Draai aan de dosisinstelknop om de minimale dosering in te stellen: 0,025, 0,05 of 0,1 mg, afhankelijk van welke pen u gebruikt. Zie de Pentabel.



**I** Houd PenMate® met de naald omhoog gericht. Tik een paar keer tegen de bovenkant van PenMate® om eventueel aanwezige luchtbelletjes in de pen omhoog te laten stijgen.



**J** Druk de drukknop in totdat het getal 0 in het dosisafleesvenster op één lijn komt te staan met de aanwijspijl en er een druppel groeihormoon aan de naaldpunt verschijnt.




Indien er geen druppel verschijnt, herhaal dan stap H tot en met J maximaal zes keer. Indien er na deze nieuwe pogingen geen druppel groeihormoon verschijnt, vervang dan de naald en herhaal de stappen H tot en met J nog eenmaal.


**K** Controleer dat het getal 0 in het dosisafleesvenster op één lijn staat met de aanwijspijl.




U kunt de benodigde dosis kiezen of aanpassen door de dosisinstelknop vooruit of terug te draaien totdat het juiste aantal mg op één lijn staat met de aanwijspijl.




Wanneer de pen minder dan de maximale dosis bevat (2,0, 4,0 of 8,0 mg, afhankelijk van welke pen u gebruikt), stopt de dosisinstelknop bij het resterende aantal mg.




ⓘ De dosisinstelknop klikt anders wanneer deze vooruit, terug of voorbij het resterende aantal mg wordt gedraaid.




⚠️ U mag nooit de penklikken tellen bij het instellen van het aantal mg. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ Gebruik verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.



⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.



⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.



⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.



⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.



⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.



⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.



⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.



⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.



⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.



⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.



⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.



⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.



⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.



⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.



⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.



⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.




⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.




⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.




⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.




⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.




⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.



⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen. Als u vergeet beide kapjes te verwijderen injecteert u geen groeihormoon.



⚠️ Gebruik altijd voor iedere injectie een nieuwe naald. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.



⚠️ Gooi verbogen of beschadigde naalden altijd weg.



⚠️ Zorg ervoor dat bij elke nieuwe pen altijd een druppel aan de naaldpunt verschijnt voordat u de eerste dosis injecteert.



⚠️ Gebruik nooit de groeihormoonschaalverdeling om te meten hoeveel groeihormoon u injecteert. Alleen het dosisafleesvenster en de aanwijspijl geven het exacte aantal mg aan.



⚠️ De naald is beschermd door twee kapjes.

# FlexPro® PenMate®

## Handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw FlexPro® PenMate® gaat gebruiken.



**Weggooiën**

- Als u uw PenMate® weggooit, doe dat dan volgens de lokaal geldende richtlijnen.

PenMate® bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

**Garantie**

- PenMate® dient alleen te worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met PenMate® die ontstaan wanneer deze instructies niet zijn opgevolgd.

Als u denkt dat uw PenMate® of bewaaretui defect is, zal deze door Novo Nordisk vervangen worden als u hem binnen vijf jaar na ontvangst terugbrengt naar uw leverancier voor onderzoek, samen met het afgiftebewijs dat u heeft gekregen toen u PenMate® kocht.

Als u het chargennummer van uw PenMate® nodig hebt, kunt u in de afbeelding van FlexPro® PenMate® direct na de introductie van deze handleiding zien waar u dit kunt vinden.

Voor klanten in de Europese Unie; als u of uw arts tijdens het gebruik van PenMate® reden hebt om aan te nemen dat er zich een ernstig voorval heeft voorgedaan, meld dit dan aan Novo Nordisk en aan uw nationale autoriteit.



## Uw PenMate® en Norditropin® FlexPro® pen onderhouden

Behandel uw PenMate® en Norditropin® FlexPro® met zorg:

**Bewaren en gebruik**

- Laat uw PenMate® of pen niet vallen en stoot er niet mee tegen harde oppervlakken. Als u ze laat vallen of als u vermoedt dat er iets mee aan de hand is, draai dan altijd een nieuwe naald voor eenmalig gebruik op de pen en controleer de toevoer van het groeihormoon voordat u injecteert.
- Probeer uw pen niet opnieuw te vullen – de pen is voorgevuld.
- Probeer uw PenMate® of pen niet te repareren of uit elkaar te halen.
- Stel uw PenMate® of pen niet bloot aan stof, vuil, vloeistof, direct licht of extreme temperaturen.
- Wanneer uw Norditropin® FlexPro® pen in PenMate® zit, bewaar deze dan zoals beschreven in de bijsluiting in de Norditropin® FlexPro®-verpakking.
- Bewaar uw PenMate® en Norditropin® FlexPro® pen in de meegeleverde etui als u ze niet gebruikt. De verwachte levensduur van uw PenMate® is 5 jaar bij normaal gebruik.
- De etui biedt ruimte voor vier extra NovoFine® of NovoTwist® naalden voor eenmalig gebruik.

**Reinigen en onderhoud**

- Probeer uw PenMate® of pen niet te wassen, te weken of te smeren. Indien nodig kunt u ze reinigen met een mild afwasmiddel op een vochtige doek.
- Verwijder vuil en stof met een droge zachte borstel.

## Wat u moet doen als uw Norditropin® FlexPro® bijna leeg is

**Hoeveel groeihormoon is er nog over?**  
U kunt op de schaalverdeling van uw Norditropin® FlexPro® pen zien hoeveel groeihormoon er ongeveer nog in de pen over is.

U kunt de dosisinstelknop van de pen gebruiken om exact te zien hoeveel groeihormoon er nog over is. Als de pen minder dan 2,0, 4,0 of 8,0 mg bevat, afhankelijk van de pen die u gebruikt: Draai aan de dosisinstelknop totdat deze blokkeert. Het getal dat op één lijn staat met de aanwijspijl geeft aan hoeveel mg er nog over is.

Als u meer groeihormoon nodig heeft dan er nog in de pen over is, kunt u een nieuwe pen gebruiken of uw dosis verdelen tussen uw huidige pen en een nieuwe pen.

## Het vervangen van een lege Norditropin® FlexPro®




**Hergebruik uw PenMate® door eenvoudigweg uw Norditropin® FlexPro® pen te vervangen wanneer die leeg is.**

**R** Als uw Norditropin® FlexPro® pen leeg is, draait u aan de pen en trekt u hem voorzichtig uit PenMate®.

Gooi de lege pen zonder naald weg volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige of volgens de lokale richtlijnen.

**S** Druk een nieuwe Norditropin® FlexPro® pen in PenMate® en draai aan de pen totdat u een klik hoort of voelt.

Het dosisafleesvenster op de pen zal in één lijn staan met de injectieknop op uw PenMate®.




## Het injecteren van uw dosis

Zorg ervoor dat u uw volledige dosis krijgt door de juiste injectietechniek te gebruiken.

**M** Houd PenMate® tegen uw huid. Druk op de injectieknop totdat u een klik hoort en de naald automatisch de huid binnendringt.

**N** Om te injecteren drukt u de drukknop in totdat het getal 0 in het dosisafleesvenster op één lijn staat met de aanwijspijl. Terwijl u dit doet, kunt u een klik horen of voelen.



Laat de naald tenminste **6 seconden** onder de huid om er zeker van te zijn dat u uw volledige dosis krijgt. Tijdens het wachten kunt u de drukknop loslaten.

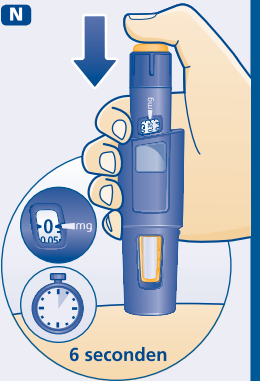

**O** Haal de naald uit de huid. Hierna ziet u mogelijk een druppel groeihormoon aan de naaldpunt. Dit is normaal en heeft geen invloed op de zojuist toegediende dosis.

**P** Plaats het buitenste naaldkapje voorzichtig terug op de naald zonder deze aan te raken. Draai de naald los en gooi deze zorgvuldig weg volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige of volgens de lokale richtlijnen.

**Q** Doe, na elk gebruik, de dop weer op de PenMate®. Indien groeihormoon aan direct licht wordt blootgesteld, kan de werking ervan verminderen.



⚠ Plaats nooit het binnenste naalddopje terug op de naald nadat u het verwijderd heeft. U zou uzelf aan de naald kunnen prikken.

⚠ Bewaar de pen in PenMate® altijd zonder een naald erop bevestigd. Dit verlaagt het risico op besmetting, infectie, lekkage van groeihormoon, verstopte naalden en onnauwkeurige dosering.

⚠ Wanneer u uw PenMate® dop kwijtraakt, neem dan contact op met uw leverancier om een nieuwe aan te vragen. Totdat u een nieuwe PenMate® dop ontvangen heeft, kunt u uw Norditropin® FlexPro® pen en pendop gebruiken zonder uw PenMate®, of u zou uw PenMate® kunnen gebruiken met de pen eraan bevestigd en deze beschermen tegen direct licht.

## Het activeren van uw PenMate®

Gebruik uw PenMate® om de naald automatisch in uw huid te brengen.

**L** Om uw PenMate® te activeren, houdt u PenMate® en Norditropin® FlexPro® vast zonder de naald, injectieknop of de drukknop aan te raken. Houd PenMate® stevig vast en trek de pen er (gedeeltelijk) uit totdat u hem op zijn plaats hoort en voelt klikken. De naald zit nu verborgen in PenMate®.



De CE-markering op een medisch hulpmiddel betekent dat het product voldoet aan de eisen in de Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745.



FlexPro® en Norditropin® zijn merknamen, eigendom van Novo Nordisk Health Care AG, Zwitserland. PenMate®, NovoFine® en NovoTwist® zijn merknamen, eigendom van Novo Nordisk A/S, Denemarken.

Uitgavedatum: 2019/05

© 2019  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd  
Denemarken

